Abbott AG
Abbott Diabetes Care
Neuhofstrasse 23
6341 Baar
Schweiz

Baar, 20. Dezember 2005

Information Produit Importante

Concernant le lecteur de glycémie Precision Xtra™

Cher Client Abbott Diabetes Care,

Ayant à l'esprit de toujours vous tenir informés au mieux sur nos lecteurs de glycémie, et, également dans un soucis de clarification de nos étiquetages, nous vous communiquons les informations qui suivent.
Cette information est relative au lecteur Precision Xtra™ qui est décrit et représenté à la page suivante.
Les informations dont nous disposons indiquent que vous êtes probablement en pocession de l'un de ces lecteurs d'Abbott Diabetes Care.
Afin de continuer à vous assurer un résultat de glycémie capillaire fiable, nous vous demandons de prendre connaissance des informations ci-jointes.
Merci de bien vouloir noter que ces informations ne concernent que le lecteur sus-mentionné et ne concernent en rien nos électrodes de mesure de la glycémie.
Si vous n'utilisez pas le lecteur Precison Xtra™, merci de ne pas tenir compte de ce courier.

Abbott Diabetes Care vous remercie de la confiance que vous accordez à nos produits.
Cette information est destinée à conforter votre ultime confiance dans les résultats que vous obtenez.
N'hésitez pas à nous contacter pour poser toutes vos questions auprès de notre numéro vert : 0 800 804 404

Sincères salutations,

Katrin Stiefel
Regulatory & Quality Affairs
Deutschland, Österreich & Schweiz

Paolo Pollak
Sales & Marketing Manager
Schweiz

Abbott
A Promise for Life

Ce courrier vous informe sur un point important concernant l'utilisation des lecteurs Abbott Diabetes Care. Merci de noter que les lecteurs Precision™ QID et Precision Xceed™ ne sont pas concernés. De plus, cette information ne concerne pas les électrodes de mesure de la glycémie. Afin de continuer à vous assurer un résultat de glycémie fiable, nous vous demandons de prendre connaissance des informations suivantes.

Les lecteurs de la gamme Abbott Diabetes Care possèdent tous un ecran sur lequel apparaissent les résultats ou toute autre information importante. L'ecran d'affichage est composé de "segments" qui apparaissent ou disparaissent pour former des lettres et des chiffres. Nous avons récemment constaté que pour certains lecteurs Precision Xtra™, ces segments pouvaient être manquants et ce, à un taux plus élevé que celui attendu. Cela peut entraîner que certaines lettres ou chiffres apparaissent de maniere incomplete, voire manquant. Si l'affichage ne se fait pas correctement, il se peut par conséquent que la valeur numérique ou alphabétique qui apparaît à l'écran puisse être mal interprétée, voire illisible. Ainsi, comme précise le manuel d'utilisation, il est important de contrôler le lecteur à chaque démarrage afin de vous assurer que tous les segments du lecteur de votre patient soient actifs. Bien que cet incident soit très rare et qu'il n'ait été rapporté, par le biais des appels des patients, que dans moins de 0,35 % des cas nous agissons de manière pro active et vous informons de cette situation.

1. Appuyez lsur le bouton de démarrage du lecteur et le maintenir enfoncé
2. Le lecteur s'allume et un affichage apparaît l'écran pendant environ 3 secondes. Le lecteur affiche alors 3 caractères ayant chacun la forme d'un huit (8). Un point de séparation (virgule anglosaxonne) apparaît entre chaque caractère (8)
3. Assurez-vous de la plénitude de chaque caractère (8.8.8) en vérifiant l'apparition de chaque segment.

Lecteur de glycémie Precision Xtra™

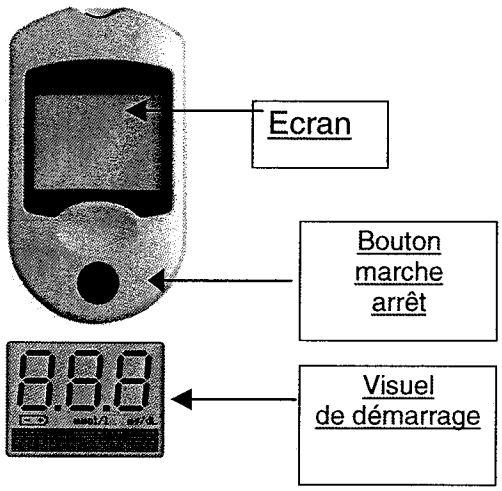

4. Si tous les segments de chaque caractère apparaîssent comme ci-dessus indiqué, vous pouvez continuer à utiliser votre lecteur.

5. **Si le moindre segment du moindre caractère n'apparaîssait pas à l'écran, cessez immédiatement l'utilisation de ce lecteur et appelez immédiatement notre numéro vert au 0 800 804 404 afin d'obtenir en échange un nouveau lecteur.**